


Stabilizovaný zdroj NG1620

Popis

Jedná se o laboratorní zdroj s plynulou regulací napětí v rozsahu 0 až 15 V s možností nastavení omezení proudu od 0 do 2 A. Je vybaven měřicími přístroji zvláště pro indikaci napětí i proudu.

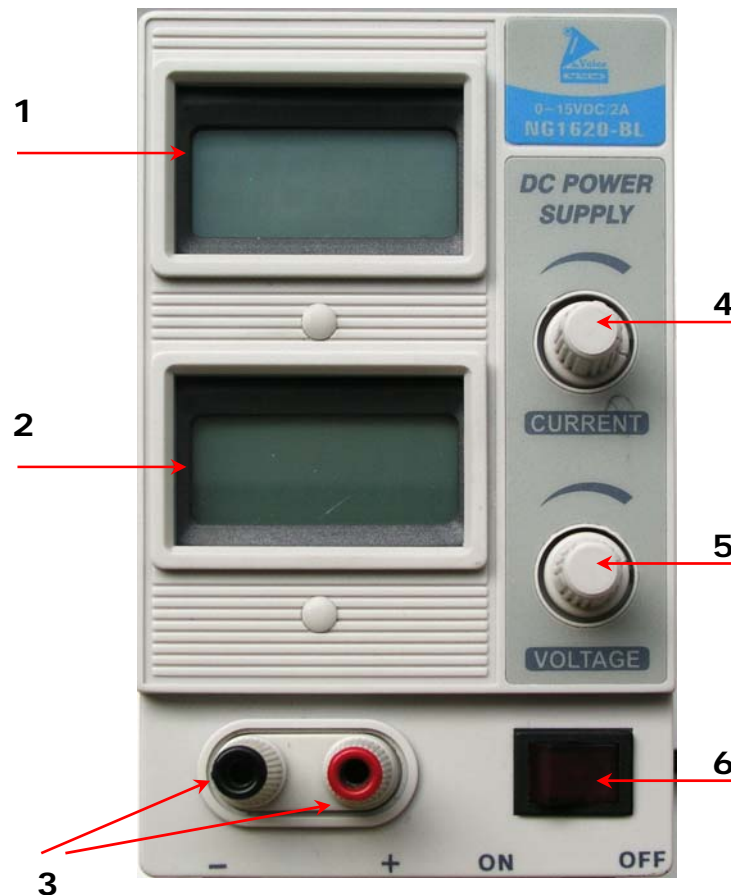

1. Displej měřidla proudu (A)
2. Displej měřidla napětí (V)
3. Výstupní svorky
4. Regulace výstupního proudu
5. Regulace výstupního napětí
6. Zapnutí/vypnutí zdroje

Technické údaje

Výstupní napětí:	0 až 15 V
Výstupní proud:	0 až 2 A
Zvlnění typické:	1 mV nebo 3mA
Třída přesnosti měřících přístrojů:	2,5